

往診セット



suniray2



MoveRay

MoveRayは超軽量・コンパクト、しかも充電式でコードレス。
極小焦点径0.4mmと高出力70kVにより実現される高精細な画像は、
訪問診療でも院内でも精度高い診断に貢献します。



一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 販売名：ムーブレイ 認証番号：225AHBZX00012000
医療機器の分類：管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

往診セット撮影画像

サイズ1(M)

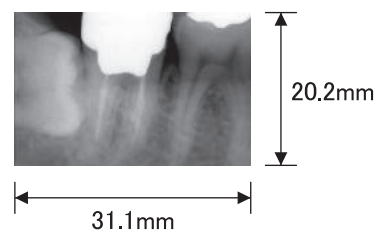

サイズ2(L)

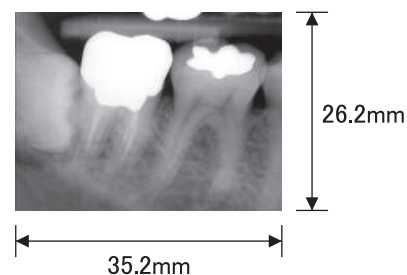

(実寸大)

suniray2

デンタルX線用センサー




製造販売業者：
株式会社アイキャット

iCAT Osaka 大阪市淀川区西中島3-19-15 第3ミツ矢ビル3F
iCAT Tokyo 東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F

0120-167-190 info@icatcorp.jp


受付時間：午前9:00～午後6:00（土日祝日は除きます）



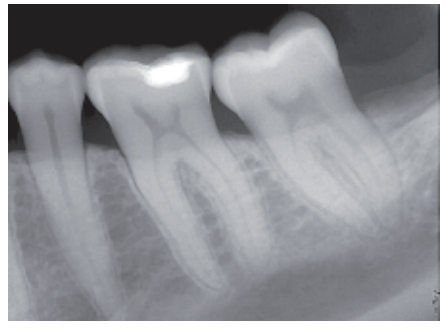


■ 高画質

独自の特許技術によるCMOSセンサーは、低被曝、S/N比、ラインペアの最適なバランスを実現。可能な限りの短時間で、最高画質が得られるように設計されています。

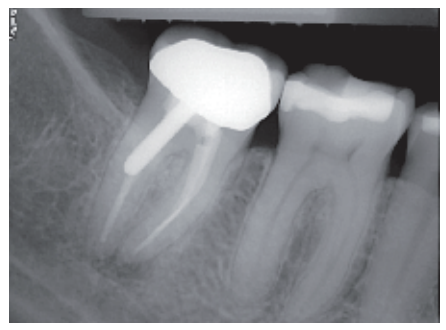


■ 広範囲

四隅ぎりぎりまでセンサーを配し、一度に撮影できる範囲を可能な限り広げました。広範囲の撮影は不必要な再撮影を防ぎ、被曝の軽減にもつながります。

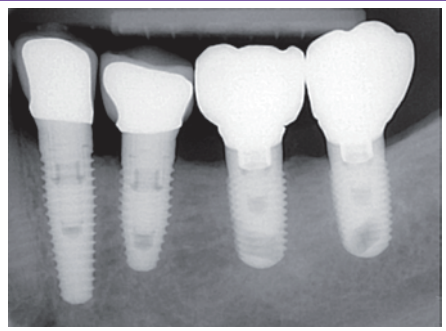


■ 耐久性

強化ボディーとケーブル接続部の強化により優れた耐久性を実現。衝撃保護技術により引っ張り、圧迫などの余分な力が加わってもセンサーの動作に影響はありません。

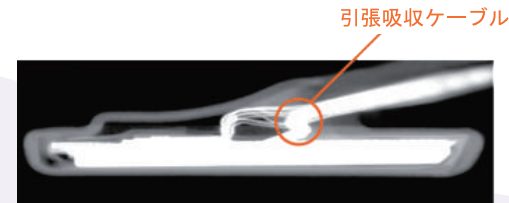


■ 高メンテナンス性

センサーと電子回路が分離した設計で、万が一故障しても装置全体の交換ではなく個別に修理が可能です。また、USBケーブルは取り外し式で、もし断線などケーブルの不具合が発生しても交換可能でメンテナンス費用を低減できます。

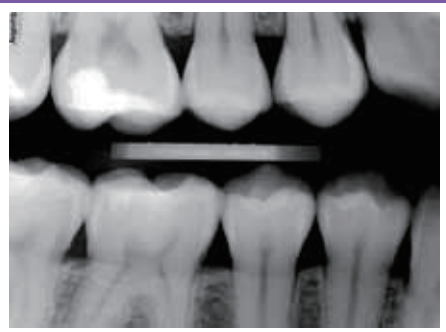

■ 低被曝

必要最小限のX線照射で高画質を実現。被曝はデンタルセンサーでは最低水準です。

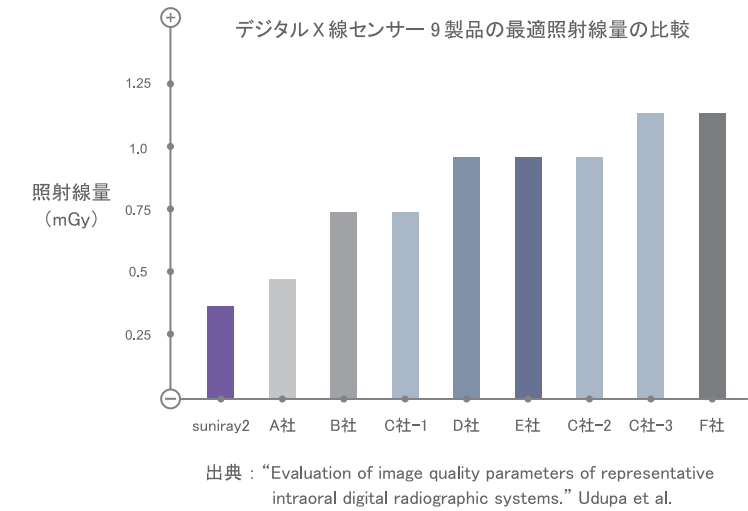

■ 快適性

長期間の使用に耐える堅牢さを確保しながらも薄く、四隅までセンサーを配していても丸みを持たせたデザインで、機能と患者さまの快適性を両立しました。



■ スペック

製品仕様	サイズ1 (M)	サイズ2 (L)
センサーサイズ (mm)	39.5 x 26.0	43.5 x 31.5
有効エリア (mm)	31.1 x 20.2	35.2 x 26.2
画素数	944 x 613	1067 x 794
センサータイプ	CMOS Active Pixel Sensor型	
最大濃度階調	4096	
センサーケーブル長 (m)	1.8、4.6	
販売名	SUNI レイ 2	
一般的名称	歯科用デジタル式X線センサ	
医療機器の分類	一般医療機器	
届出番号	27B2X00231000012	
製品保障	2年間	